Sinocare

تحكّم بمستوى الجلوكوز لديك مع جهاز

iCan i6 CGM

15 يوم

مراقبة الجلوكوز المستمرة

Sinocare | iCan

الاهتمام لإظهار الحب

نظام CGM

شركة Changsha Sinocare Inc
العنوان: رقم 265، طريق جويوان، منطقة التكنولوجيا العالية، تشانغشا، مقاطعة هونان، 410205، جمهورية الصين الشعبية
الموقع الإلكتروني: www.sinocare.com
البريد الإلكتروني: intl_mkt@sinocare.com

CGM: أداة أفضل لمراقبة مستوى الجلوكوز

- **نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM)** هو نظام يقيس مستويات الجلوكوز باستمرار على مدار اليوم والليلة.

يتضمن عادةً مستشعرًا صغيرًا يُزرع تحت الجلد، ويقيس الجلوكوز في السائل الخلالي (السائل الموجود بين الخلايا).

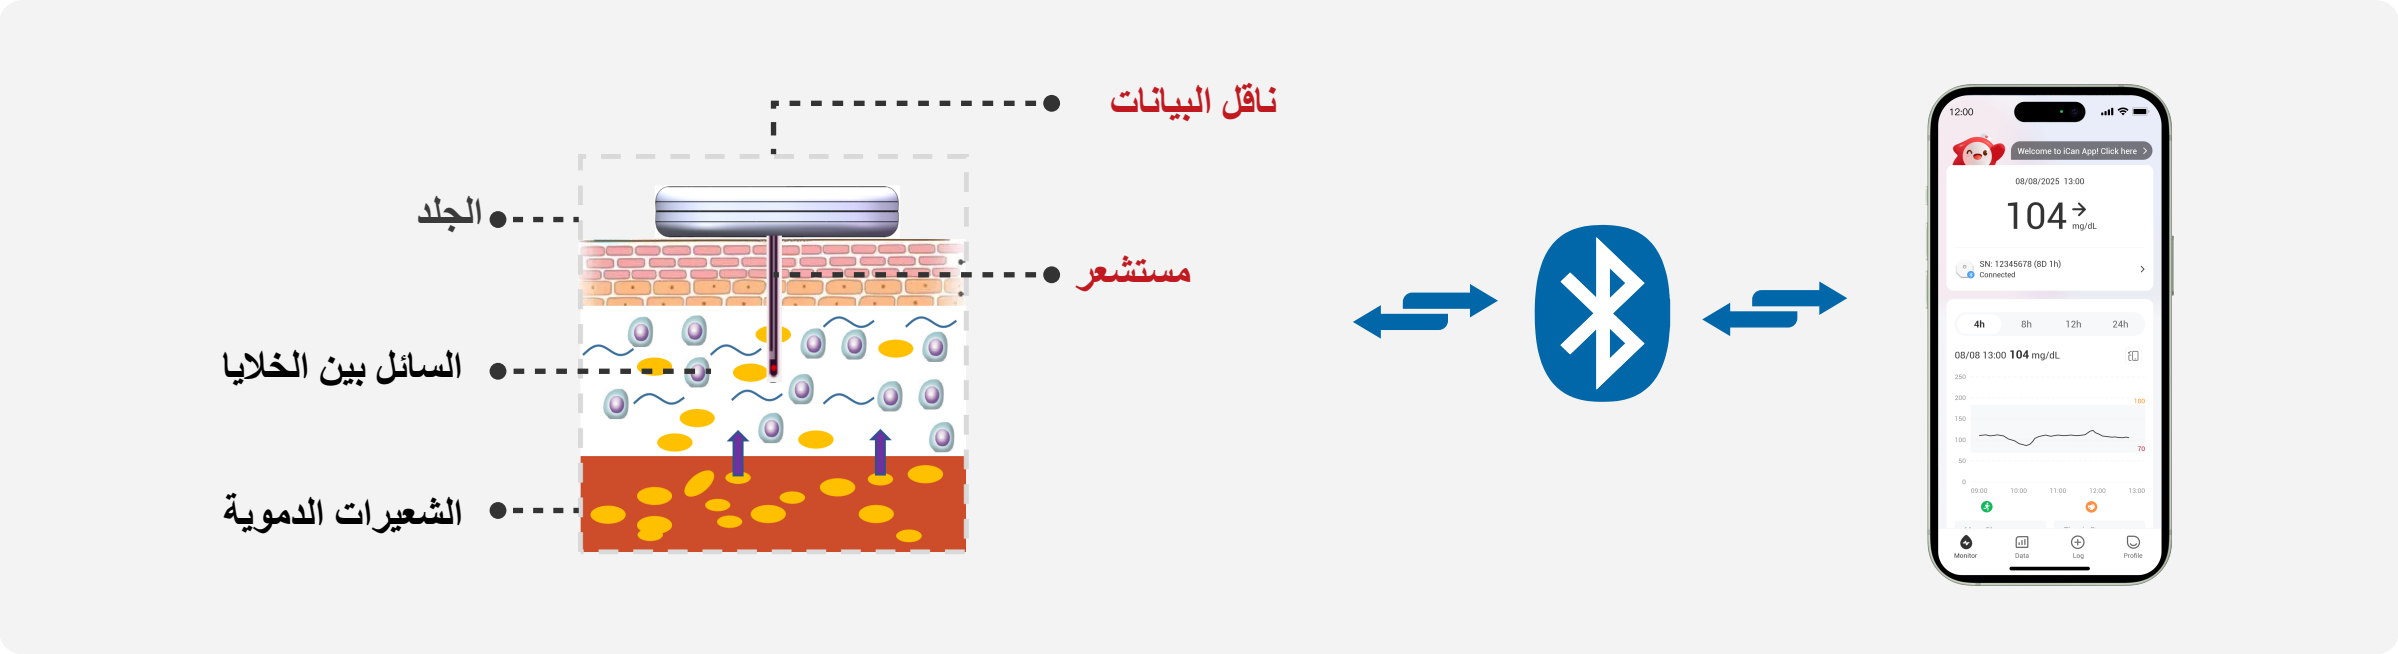

الاختلافات الرئيسية بين نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) ونظام مراقبة الجلوكوز في الدم (BGM)

الميزة	جهاز القياس المستمر لسكر الدم	BGM
نوع المراقبة	✓ تتبع مستمر وفوري	اختبارات فردية منفصلة
نوع السائل اللذي يتم به قياس السكر	✓ السائل الخلالي	عينة دم شعيرية (عن طريق وخز الإصبع)
تكرار البيانات	✓ كل بضع دقائق	اختبار واحد في كل مرة
التنبيهات	✓ نعم، لمستويات الجلوكوز المرتفعة/المنخفضة	لا توجد تنبيهات يلزم إجراء اختبار يدوي
الراحة	✓ مستشعر صغير تحت الجلد	يلزم وخز الإصبع لكل اختبار
المدة	✓ يدوم المستشعر من أيام إلى أسابيع	يُجرى الاختبار فقط في لحظة الاختبار

أول جهاز لمراقبة السكر فى العالم يستمر لمدة 15 يوم

15 يوم عمر استخدام

3 دقائق التكرار

8.71%
قيمة متوسط نسبة الفرق المطلق (MARD)

مضاد للتداخل
(أسيتامينوفين وفيتامين ج)

مقاوم للماء
IP28
2.5 متر، ساعتان

مناسب للأعمار من سنتين فما فوق

الإدارة الرقمية
نظام إدارة مرض السكري

منصة iCan Review
برنامج الطبيب

iCan Reach
تطبيق شريك الرعاية

تطبيق iCan Health
تطبيق المريض

تقرير AGP 5.0
للمساعدة بشكل أفضل في التحكم بمضاعفات مرض السكري



من يمكنه استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر؟

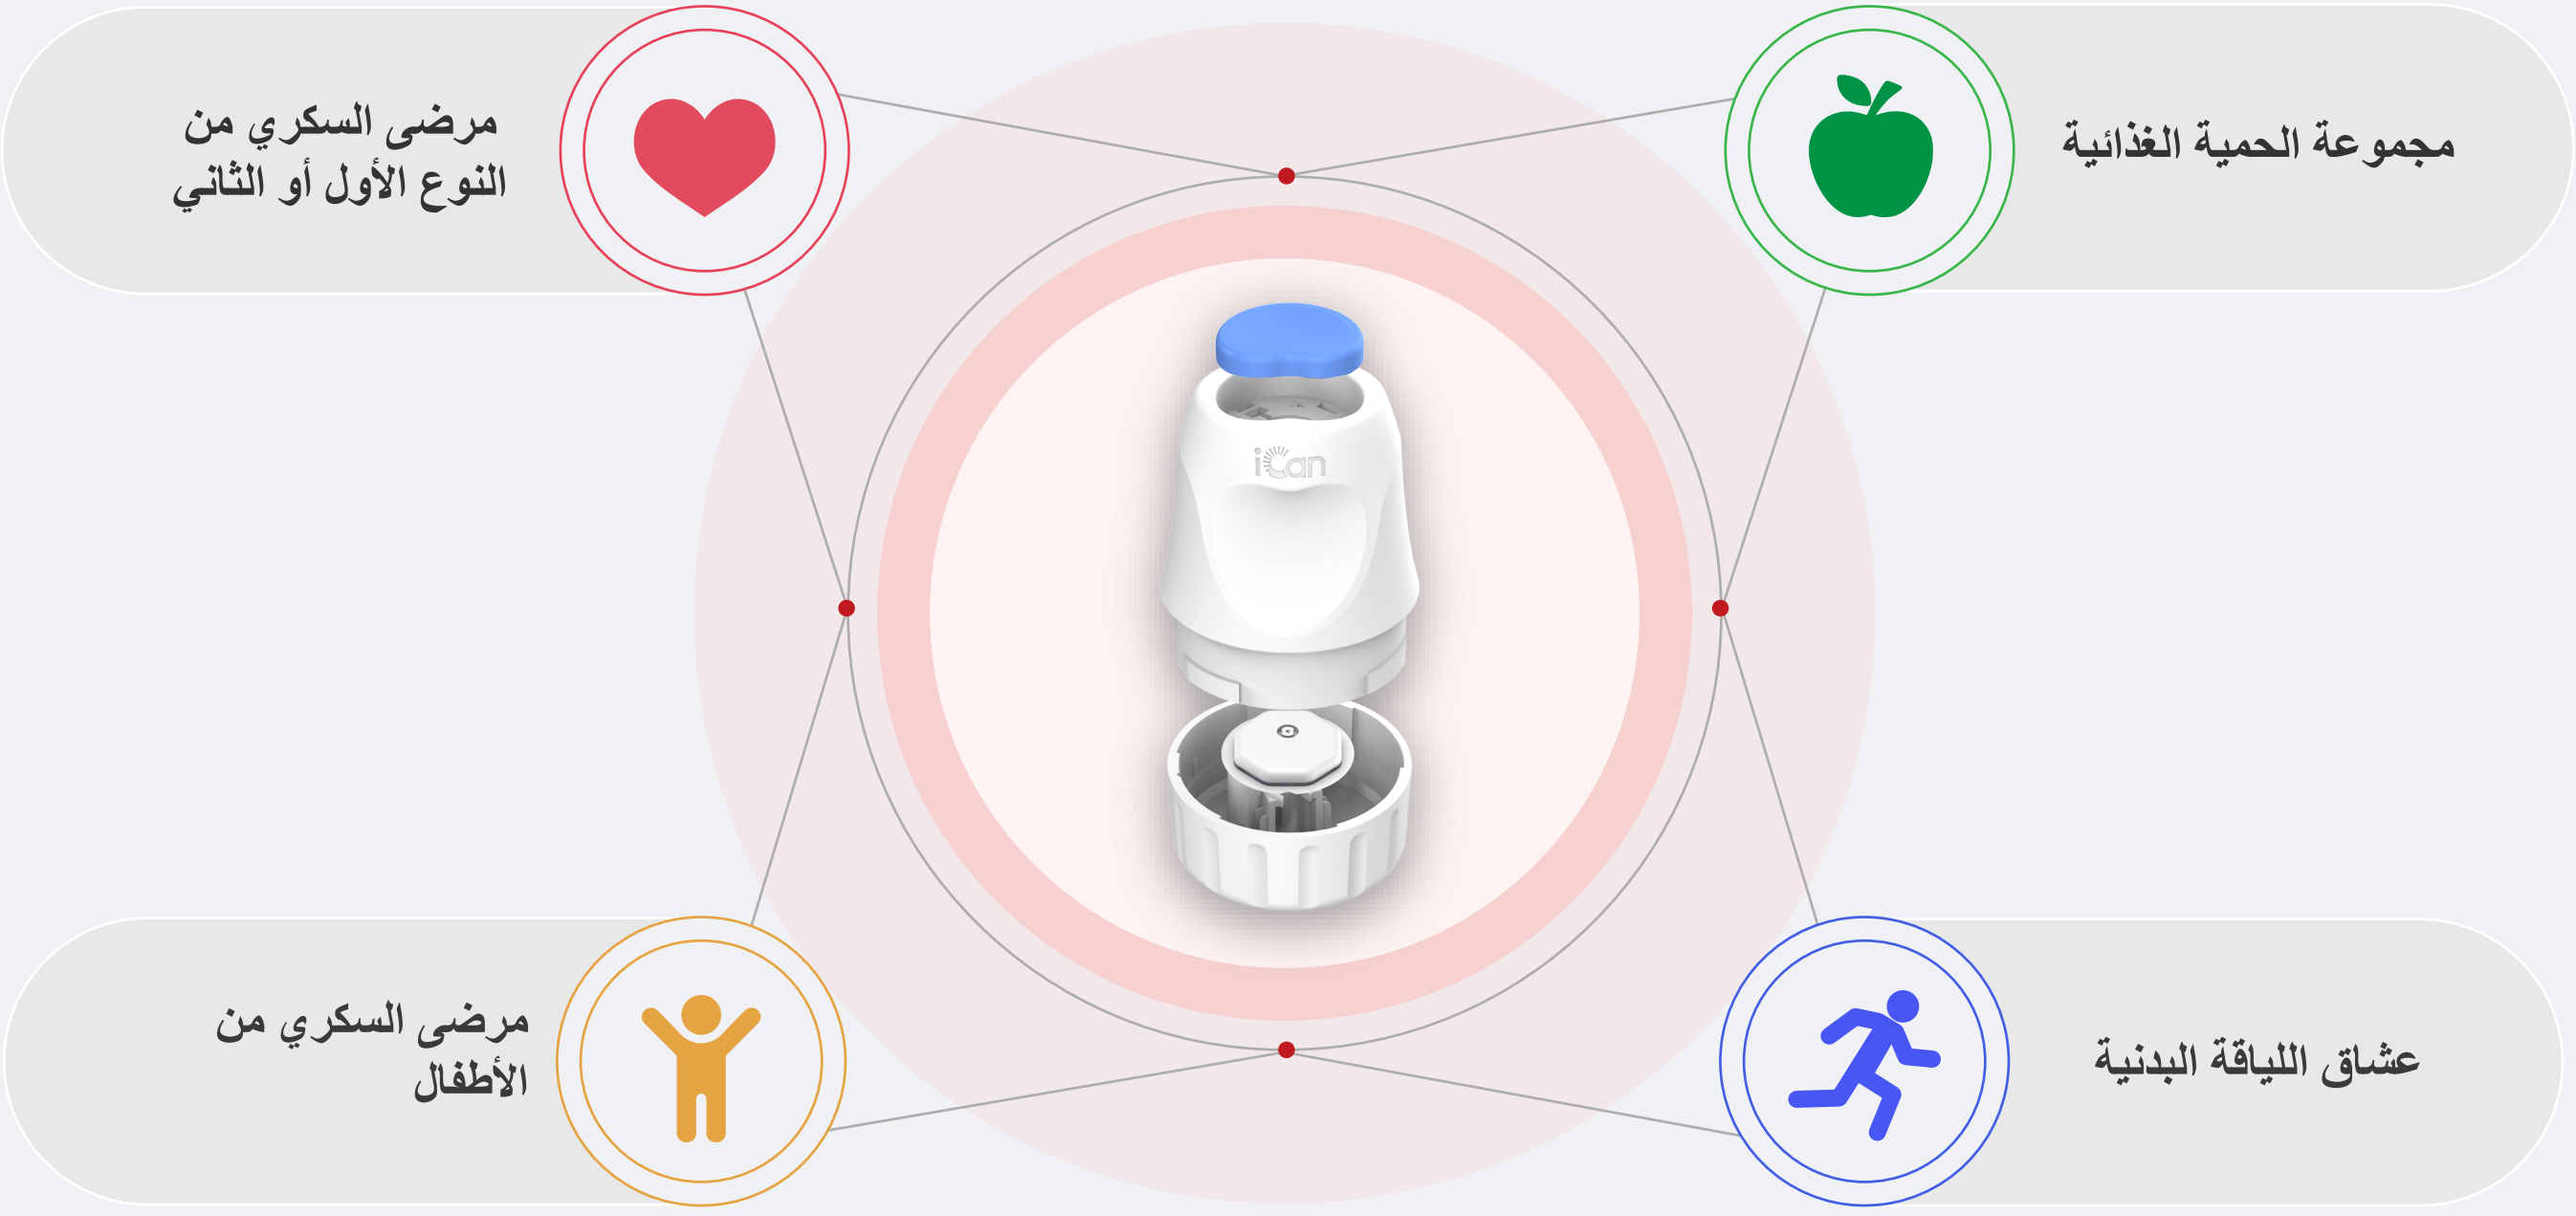

مستخدمو جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر

لماذا استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر؟

اكتشف أنماط الجلوكوز الخفية

اكتشف أنماط الجلوكوز الخفية واحصل على إنذارات مبكرة لمنع الأحداث الخطيرة.

شاهد ما يؤثر على مستوى الجلوكوز لديك

شاهد تأثير الطعام والتمارين الرياضية والأدوية والتوتر في الوقت الفعلي.

حقق تحكمًا فائقًا في مستوى السكر في الدم

زد من الوقت ضمن النطاق المستهدف (TIR) وخفّض مستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1c) مع تقليل ملحوظ في تكرار وشدة انخفاض السكر في الدم.

فعّل العلاج المُخصّص

وفّر رؤى مستندة إلى البيانات لتحسين خطط العلاج.

كيفية استخدام جهاز Sinocare iCan CGM

الخطوة 1

الإعداد باستخدام تطبيق
iCan Health

GET IT ON Google Play

Download on App Store

الخطوة 2

مسح رمز الرقم التسلسلي (SN)

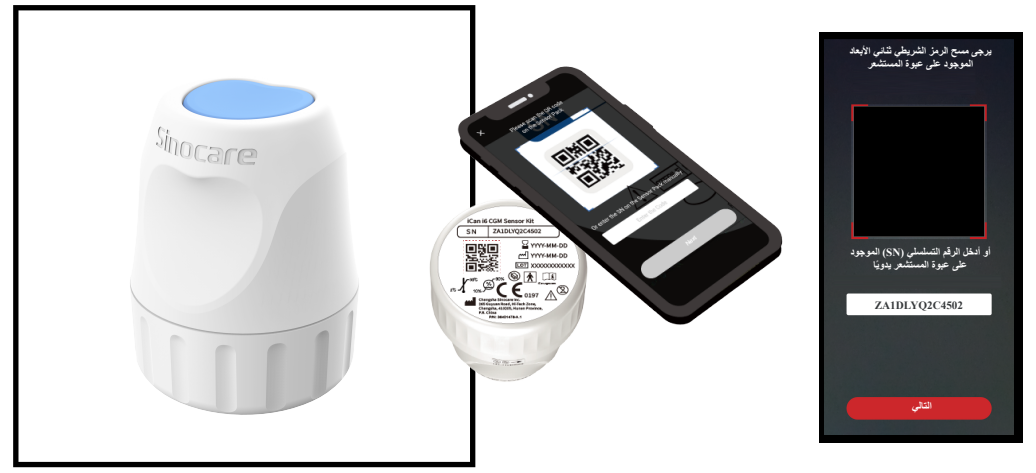

الخطوة 3

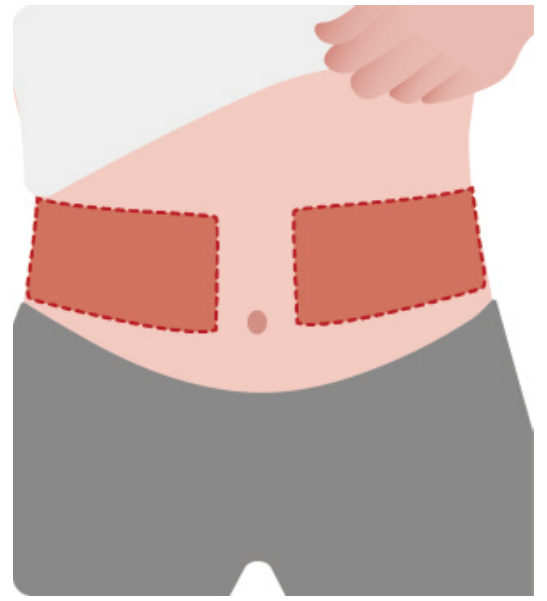



اختر موضع الارتداء

تجنب المناطق القريبة من أحزمة الخصر أو التي بها ندوب، ووشم، وتهيج، وعظام.

احتياطات الاستخدام

التعقيم

نظّف موضع الإدخال بقطعة قطن مبللة بالكحول واتركه يجف تمامًا قبل الإدخال

فك الغطاء باللف

تحقق من عبوة المستشعر قبل الاستخدام. لا تستخدم الجهاز إذا كان الملصق مفتوحًا أو تالفًا.

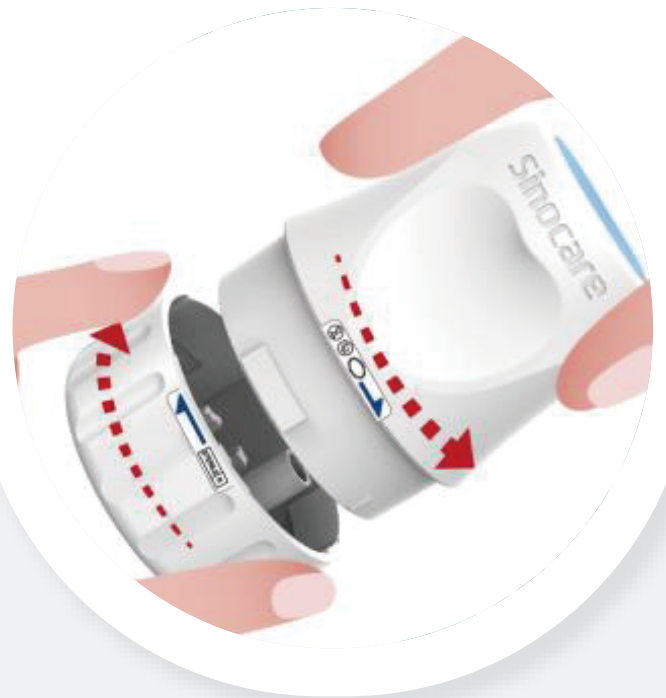

الإدخال

قم باختيار موقع الادخال
قم بتثبيت الجهاز على الموقع
ثم قم بالضغط على الزر فى المنتصف

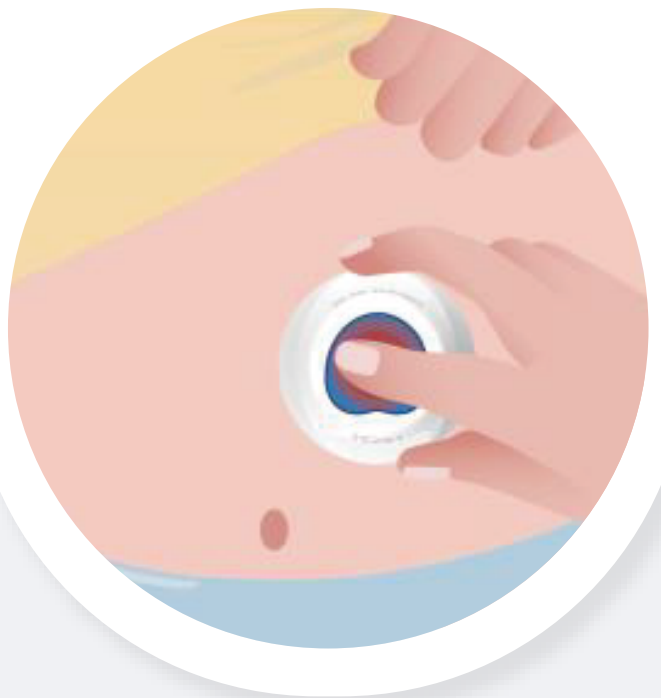

ضع اللاصقة الإضافية

إذا لزم الأمر، ضع اللاصقة الإضافية دون لمس منطقة اللصق.

استخدم تطبيق iCan Health لإدارة مستوى الجلوكوز

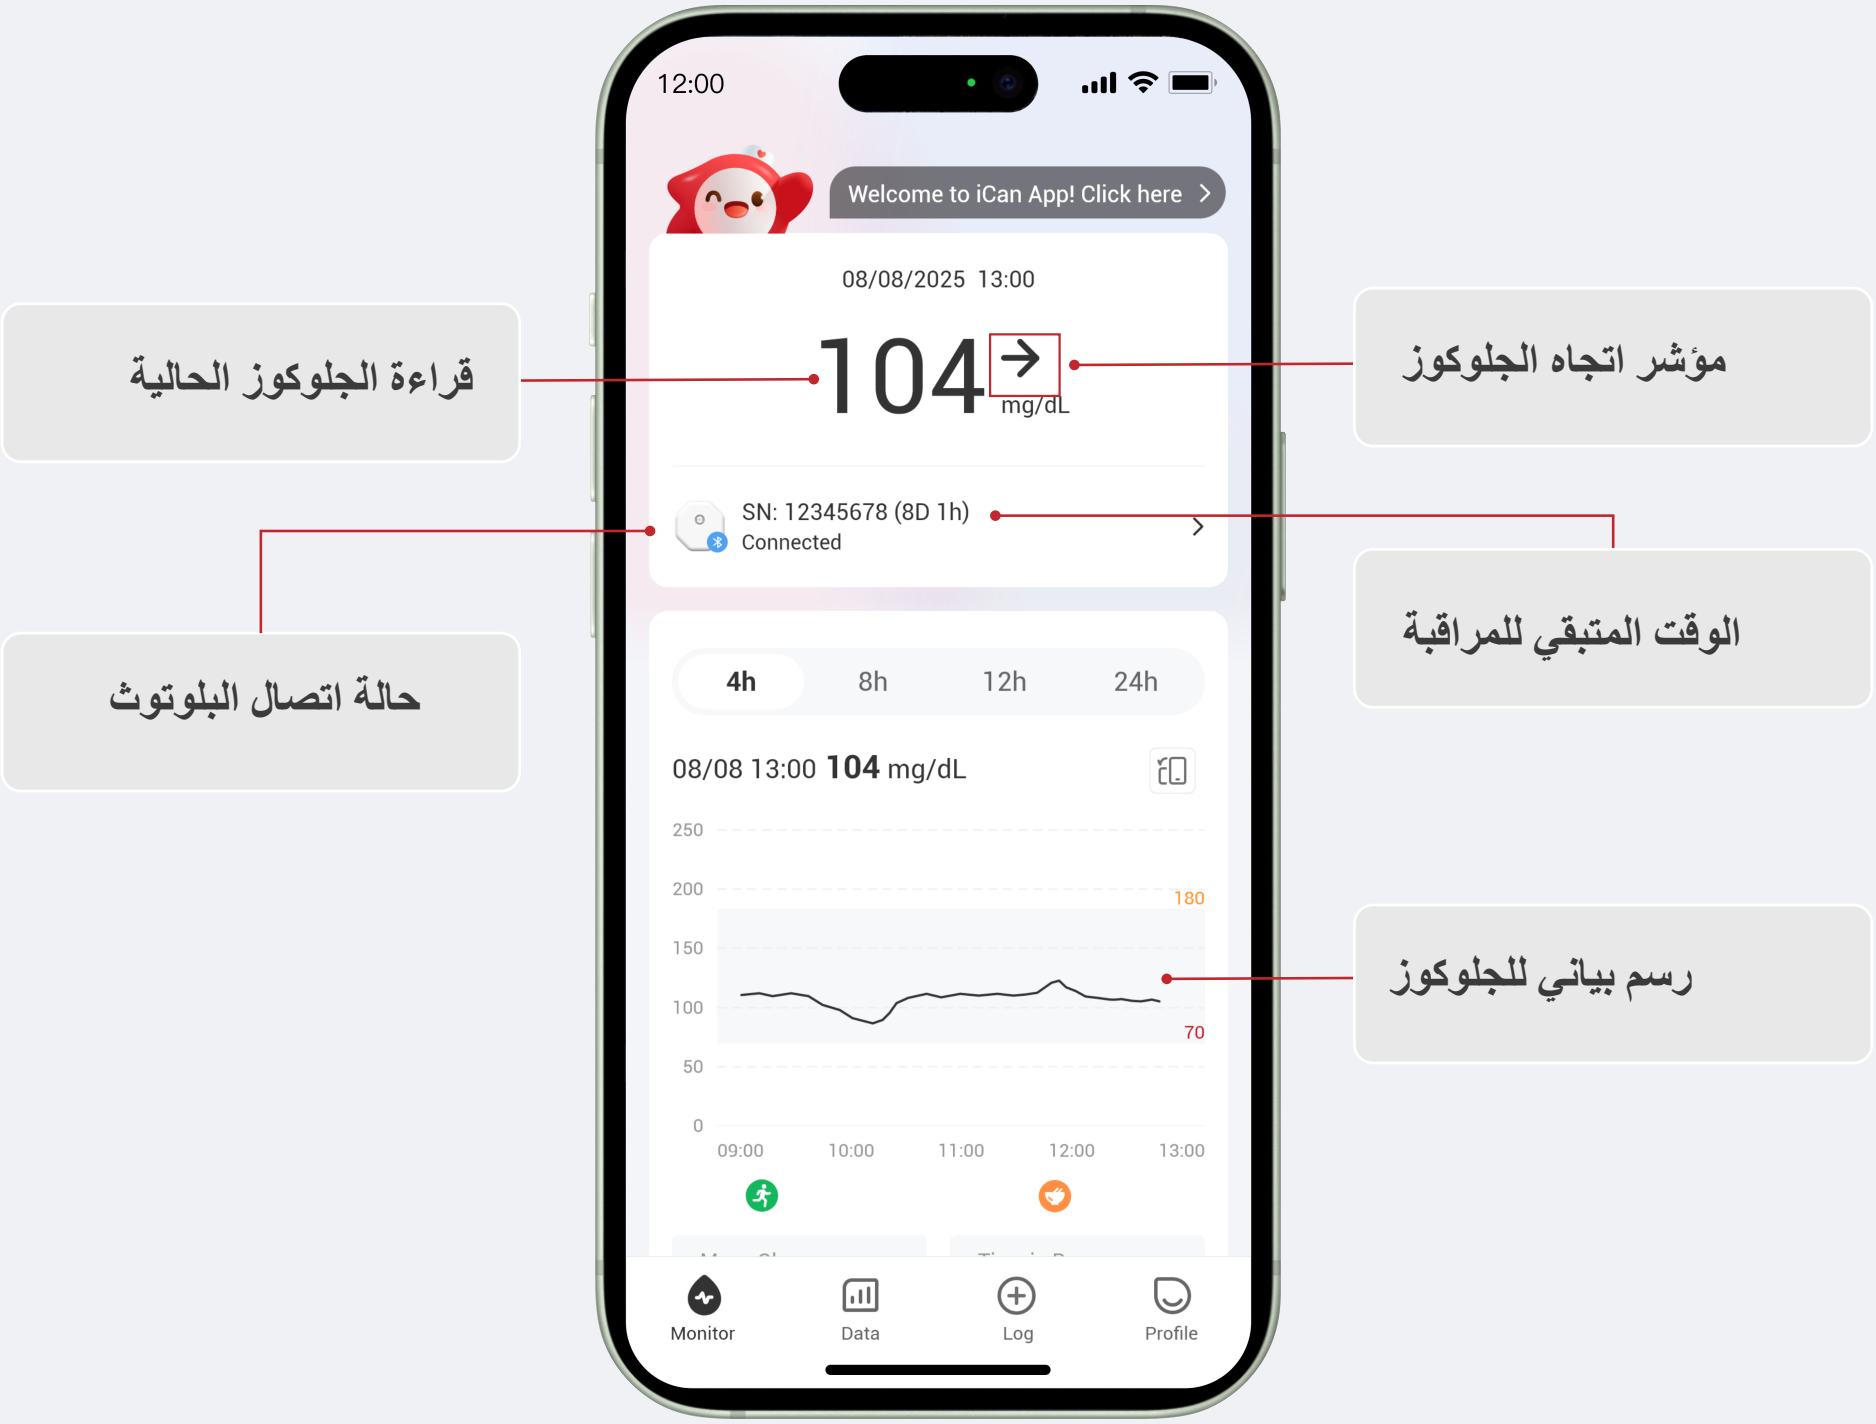

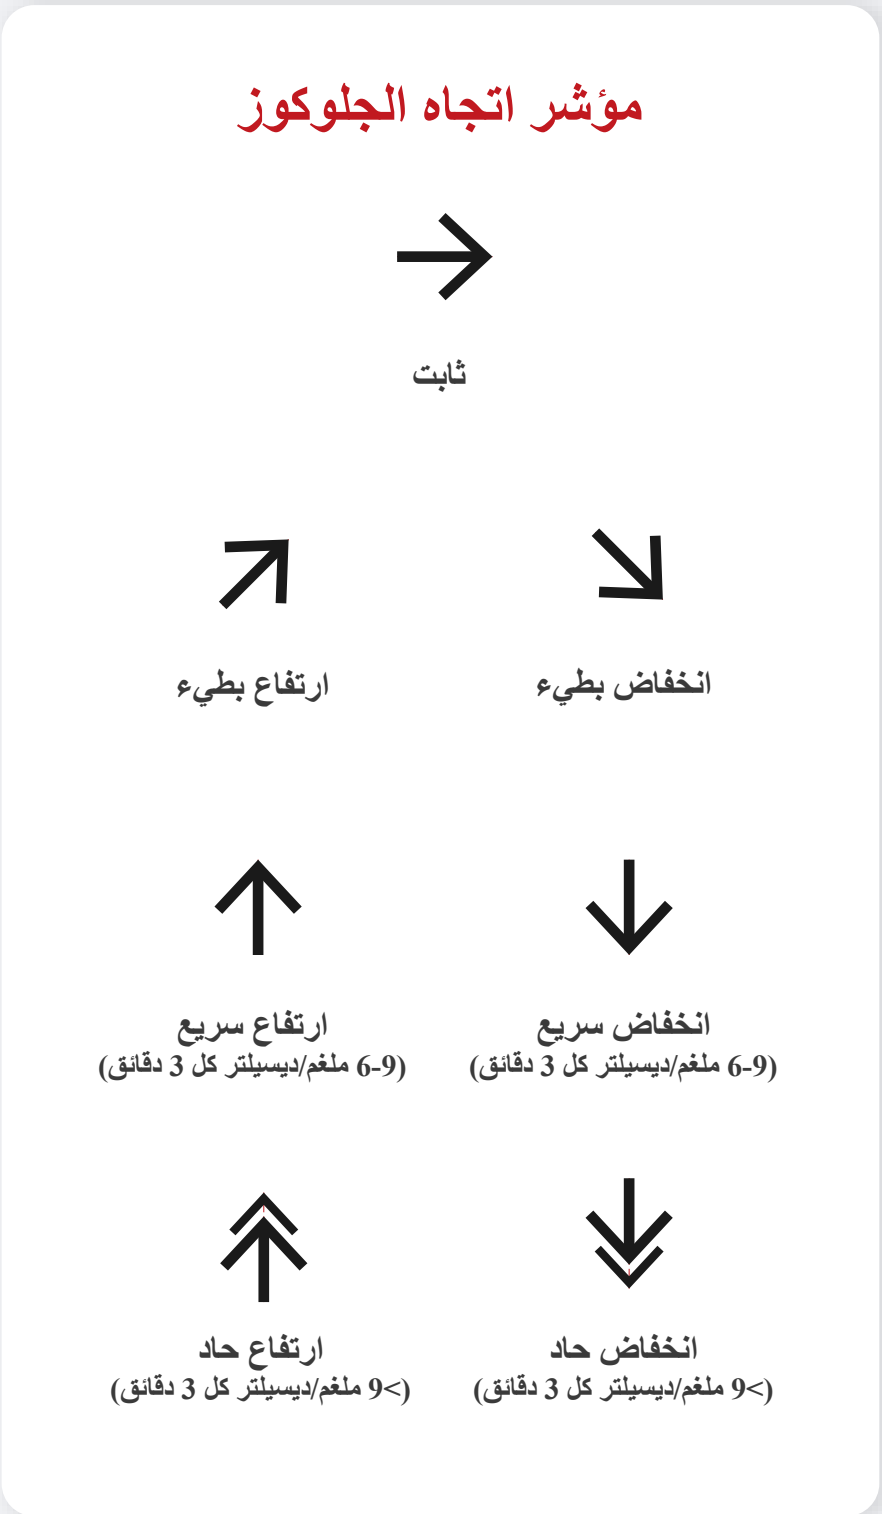

مؤشر اتجاه الجلوكوز

ثابت

انخفاض بطيء	ارتفاع بطيء
انخفاض سريع (6-9 ملغم/ديسيلتر كل 3 دقائق)	ارتفاع سريع (6-9 ملغم/ديسيلتر كل 3 دقائق)
انخفاض حاد (9< ملغم/ديسيلتر كل 3 دقائق)	ارتفاع حاد (9< ملغم/ديسيلتر كل 3 دقائق)

تنبيهات قابلة للتخصيص ـ ذكية، مرنة، تحكم دائم

تنبيهات شخصية بالكامل

خصص تنبيهات ارتفاع/انخفاض الجلوكوز و التغيرات السريعة بالاهتزاز أو الصوت لتناسب تفضيلاتك.

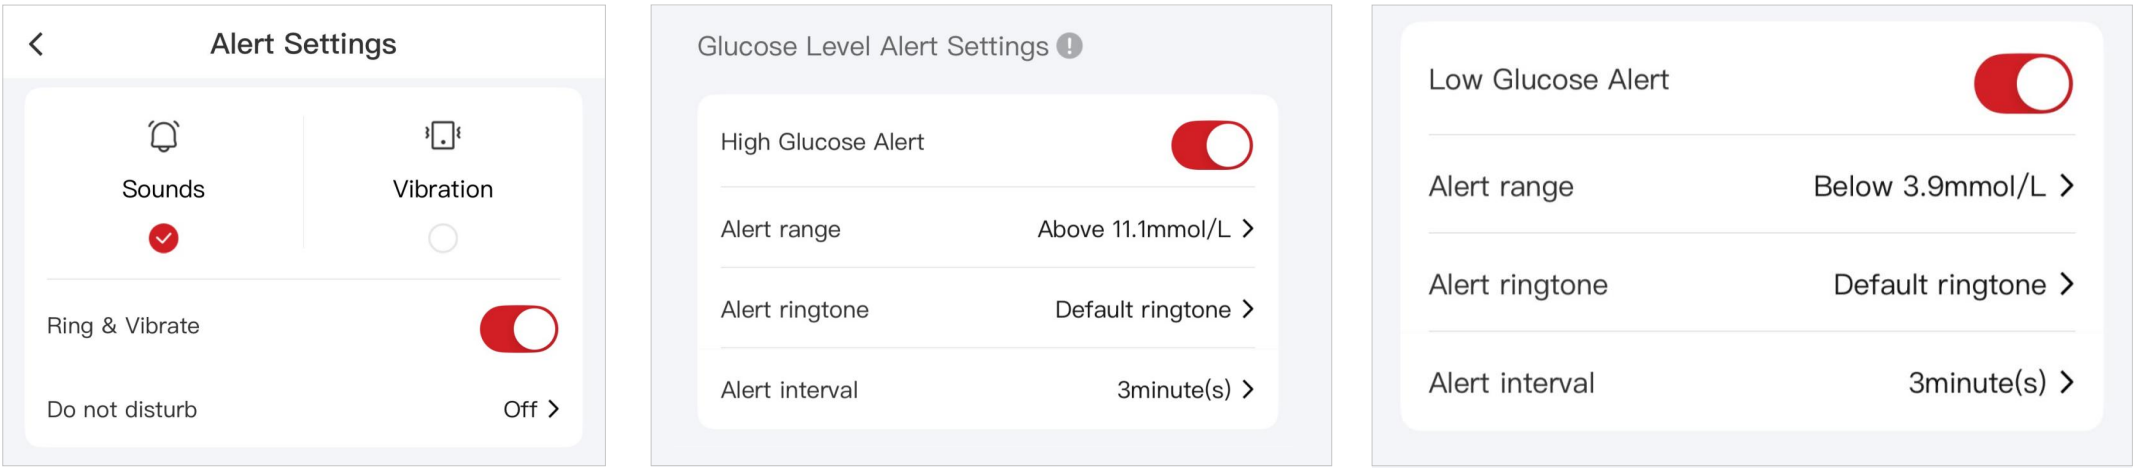

Alert Settings

Sounds ● Vibration ○

Ring & Vibrate: on

Do not disturb: Off

Glucose Level Alert Settings

High Glucose Alert: on

Alert range: Above 11.1mmol/L

Alert ringtone: Default ringtone

Alert interval: 3minute(s)

Low Glucose Alert: on

Alert range: Below 3.9mmol/L

Alert ringtone: Default ringtone

Alert interval: 3minute(s)

تحليل غذائي

راجع اتجاهات الجلوكوز بعد الوجبات لفهم تأثير الأطعمة المختلفة على جسمك

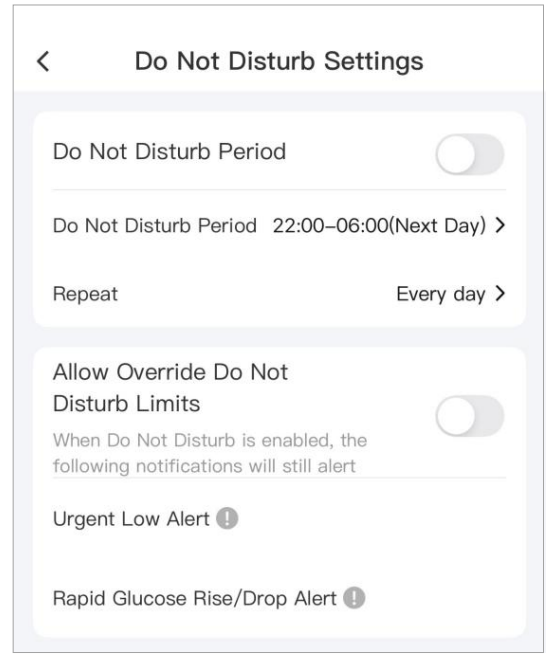

Do Not Disturb Settings

Do Not Disturb Period: off

Do Not Disturb Period: 22:00–06:00(Next Day)

Repeat: Every day

Allow Override Do Not Disturb Limits: off

When Do Not Disturb is enabled, the following notifications will still alert

Urgent Low Alert

Rapid Glucose Rise/Drop Alert

فترات تنبيه مرنة

اضبط التنبيهات من 3 دقائق إلى ساعتين ، لتناسب التنبيهات يومك دون أي إزعاج.

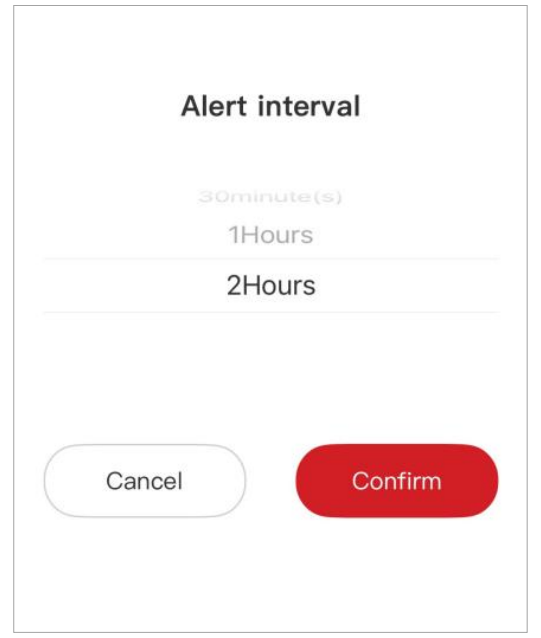

Alert interval

30minute(s)

1Hours

2Hours

Cancel | Confirm

شارك بيانات مستوى الجلوكوز مع شريك الرعاية

- استخدم تطبيق iCan Reach لتمكين مشاركة البيانات عن بُعد وحماية صحة مستوى الجلوكوز لديك.

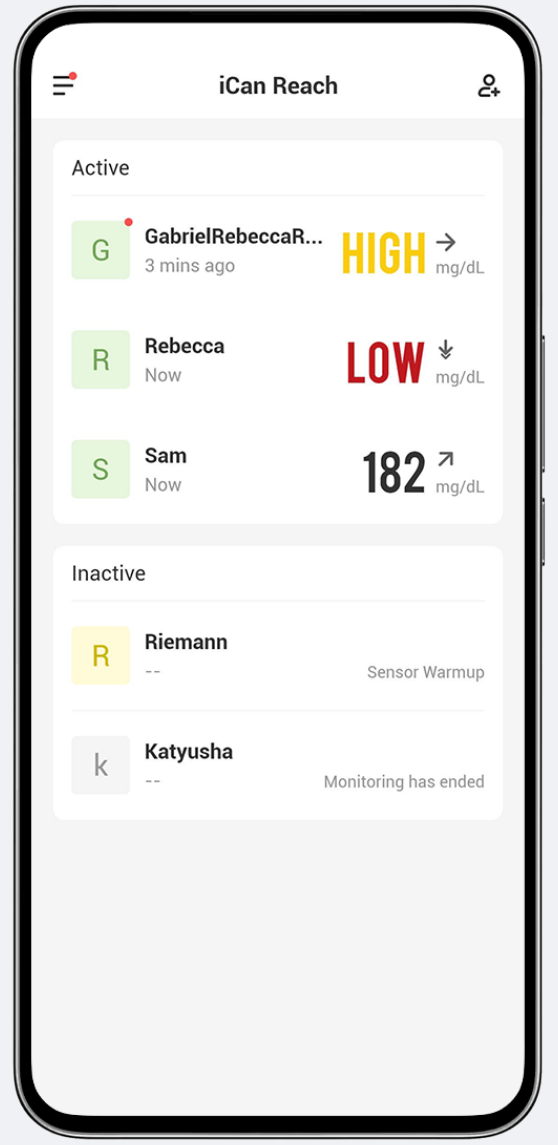

الصفحة الرئيسية

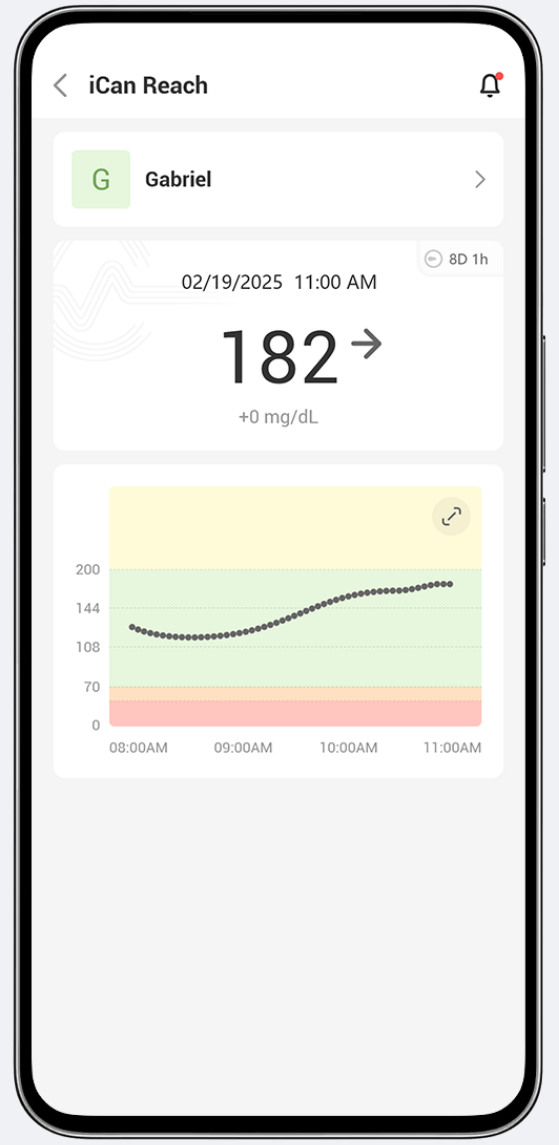

عرض بيانات مستخدم جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM)

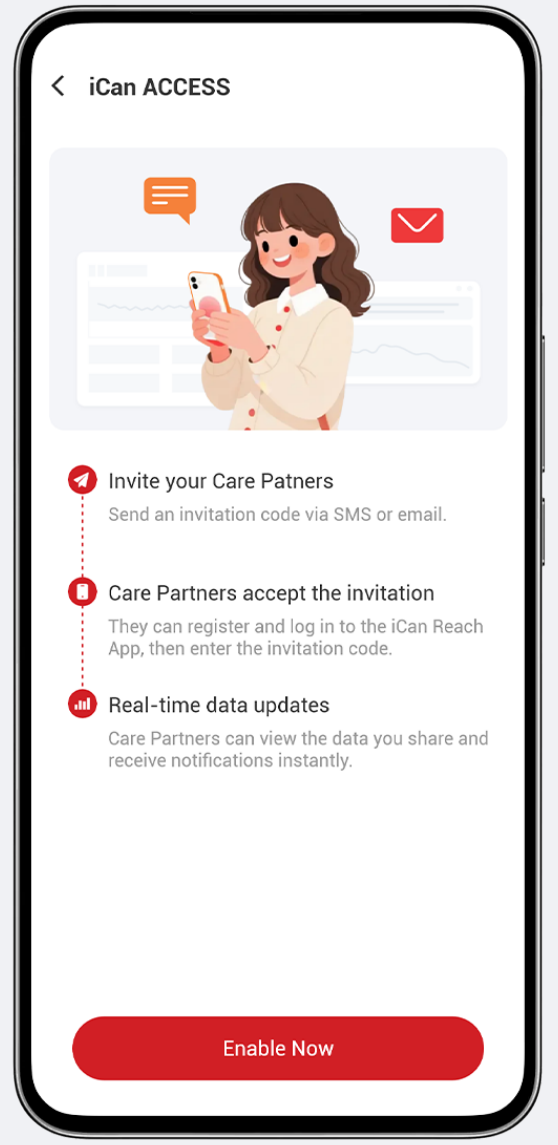

Invite your Care Patners
Send an invitation code via SMS or email.

Care Partners accept the invitation
They can register and log in to the iCan Reach App, then enter the invitation code.

Real-time data updates
Care Partners can view the data you share and receive notifications instantly.

قم بإضافة شريك الرعاية الصحية

شارك بيانات مستوى الجلوكوز مع مقدمي الرعاية الصحية

- استخدم برنامج iCan Review لتمكين مشاركة البيانات عن بُعد وحماية صحة مستوى الجلوكوز لديك.

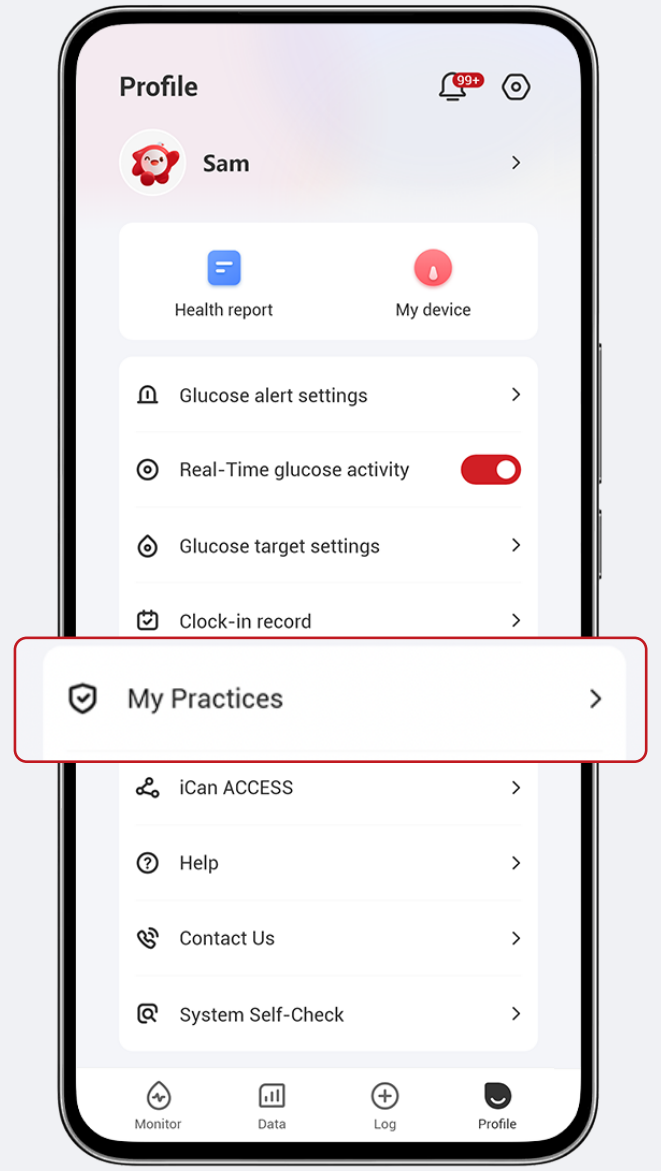

أدخل بيانات الوصول إلى "ممارساتي" في تطبيق CGM

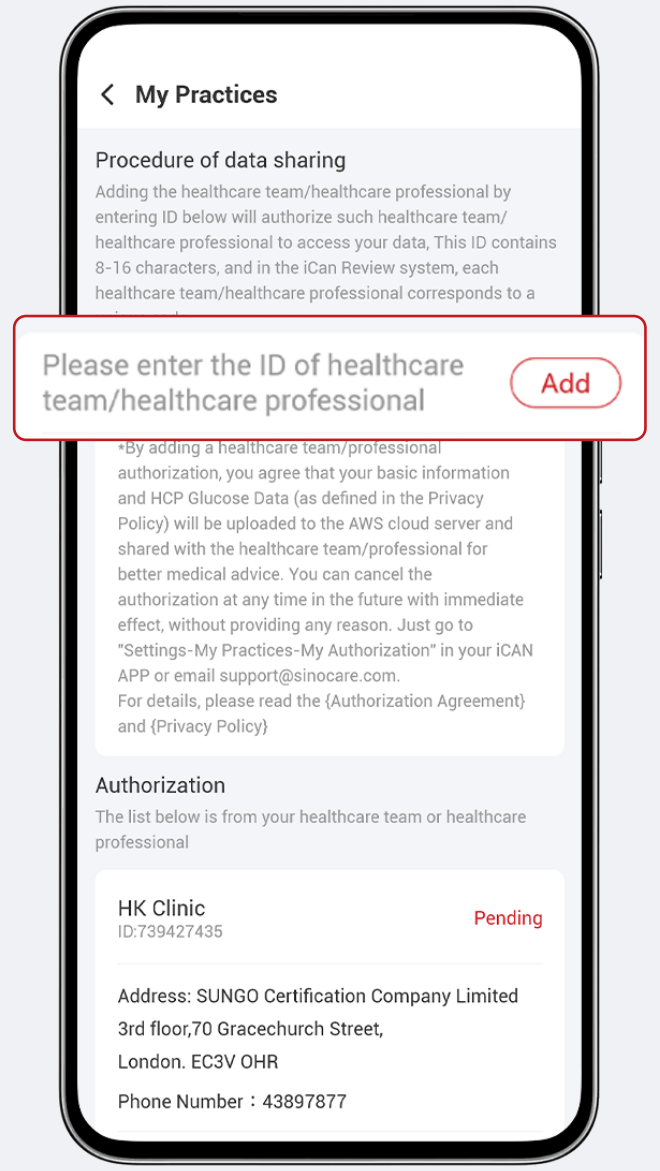

Procedure of data sharing
Adding the healthcare team/healthcare professional by entering ID below will authorize such healthcare team/ healthcare professional to access your data, This ID contains 8-16 characters, and in the iCan Review system, each healthcare team/healthcare professional corresponds to a

Please enter the ID of healthcare team/healthcare professional

*By adding a healthcare team/professional authorization, you agree that your basic information and HCP Glucose Data (as defined in the Privacy Policy) will be uploaded to the AWS cloud server and shared with the healthcare team/professional for better medical advice. You can cancel the authorization at any time in the future with immediate effect, without providing any reason. Just go to "Settings-My Practices-My Authorization" in your iCAN APP or email support@sinocare.com.
For details, please read the {Authorization Agreement} and {Privacy Policy}

Authorization
The list below is from your healthcare team or healthcare professional

HK Clinic
ID:739427435
Address: SUNGO Certification Company Limited
3rd floor,70 Gracechurch Street,
London. EC3V OHR
Phone Number：43897877

أدخل المعرف الشخصي لمقدمي الرعاية الصحية

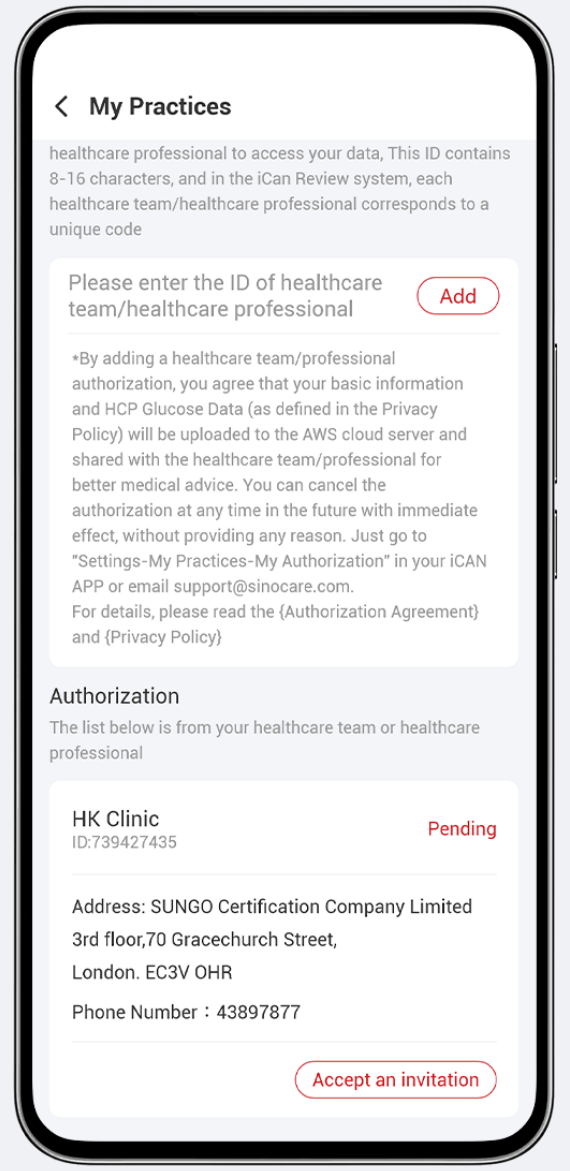

healthcare professional to access your data, This ID contains 8-16 characters, and in the iCan Review system, each healthcare team/healthcare professional corresponds to a unique code

Please enter the ID of healthcare team/healthcare professional

*By adding a healthcare team/professional authorization, you agree that your basic information and HCP Glucose Data (as defined in the Privacy Policy) will be uploaded to the AWS cloud server and shared with the healthcare team/professional for better medical advice. You can cancel the authorization at any time in the future with immediate effect, without providing any reason. Just go to "Settings-My Practices-My Authorization" in your iCAN APP or email support@sinocare.com.
For details, please read the {Authorization Agreement} and {Privacy Policy}

Authorization
The list below is from your healthcare team or healthcare professional

HK Clinic
ID:739427435
Address: SUNGO Certification Company Limited
3rd floor,70 Gracechurch Street,
London. EC3V OHR
Phone Number：43897877

تمت مشاركة البيانات بنجاح

تقارير مراقبة مستوى الجلوكوز

روية واضحة و تتبع اسهل

تتبع النمط اليومي

تتبع رسمك البياني لمستوى الجلوكوز، والوقت ضمن النطاق المستهدف (TIR)، والأحداث المسجلة (الوجبات، والأدوية، والتمارين الرياضية) لمعرفة تأثير خياراتك اليومية على مستوى الجلوكوز.

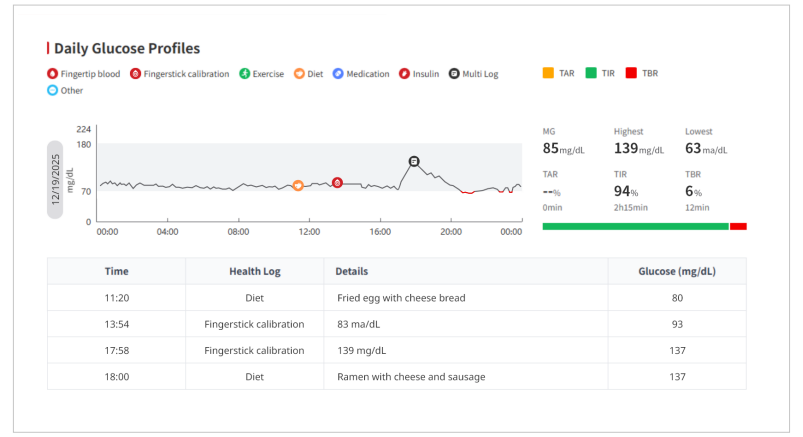

Daily Glucose Profiles

MG 85 mg/dL
Highest 139 mg/dL
Lowest 63 ma/dL
TAR --% 0min
TIR 94% 2h15min
TBR 6% 12min

Time	Health Log	Details	Glucose (mg/dL)
11:20	Diet	Fried egg with cheese bread	80
13:54	Fingerstick calibration	83 ma/dL	93
17:58	Fingerstick calibration	139 mg/dL	137
18:00	Diet	Ramen with cheese and sausage	137

نظرة عامة شاملة على مستوى الجلوكوز

اعرض أعلى مستوى، ومتوسط مستوى الجلوكوز، وأدنى مستوى للجلوكوز، بالإضافة إلى الوقت ضمن النطاق المستهدف (TIR) ومؤشر الجلوكوز (GMI) - كل ذلك في لقطة واحدة.

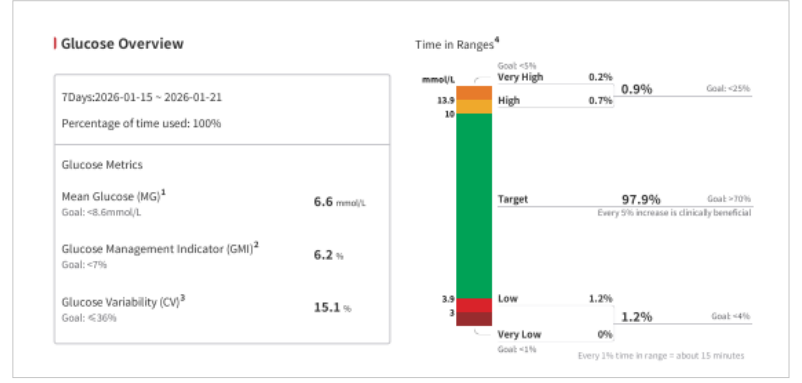

Glucose Overview

7Days:2026-01-15 ~ 2026-01-21
Percentage of time used: 100%

Glucose Metrics
Mean Glucose (MG)[1] 6.6 mmol/L
Goal: <8.6mmol/L
Glucose Management Indicator (GMI)[2] 6.2 %
Goal: <7%
Glucose Variability (CV)[3] 15.1 %
Goal: ≤36%

Time in Ranges[4]

تحليل غذائي

راجع اتجاهات مستوى الجلوكوز بعد الوجبات لمعرفة تأثير الأطعمة المختلفة على جسمك.

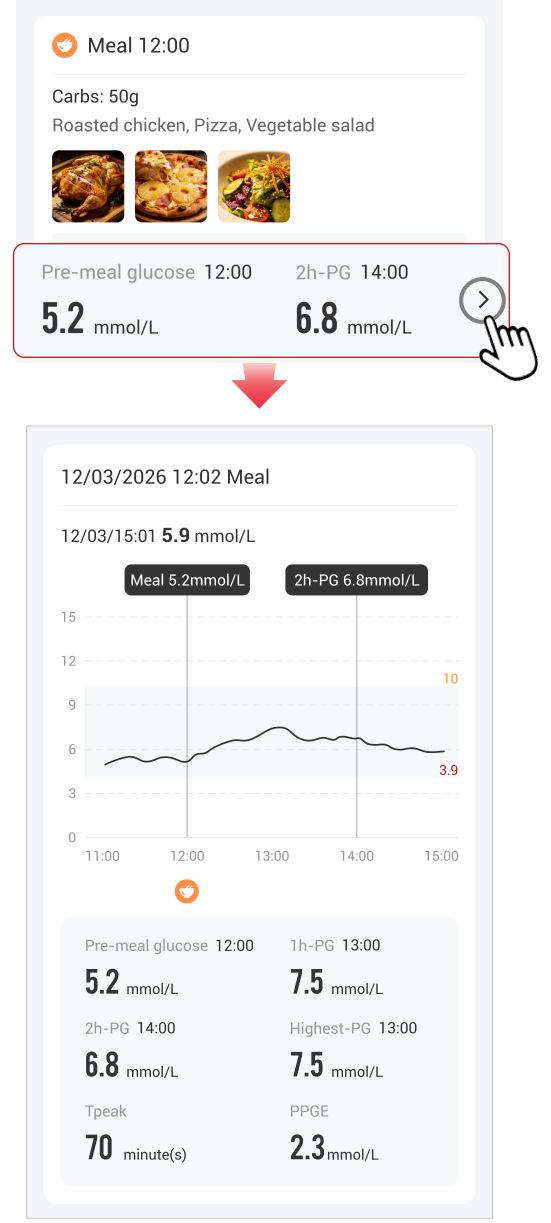

Meal 12:00
Carbs: 50g
Roasted chicken, Pizza, Vegetable salad
Pre-meal glucose 12:00 5.2 mmol/L
2h-PG 14:00 6.8 mmol/L

12/03/2026 12:02 Meal
12/03/15:01 5.9 mmol/L

Pre-meal glucose 12:00 5.2 mmol/L
1h-PG 13:00 7.5 mmol/L
2h-PG 14:00 6.8 mmol/L
Highest-PG 13:00 7.5 mmol/L
Tpeak 70 minute(s)
PPGE 2.3 mmol/L

واجهة التطبيق

سجل نظامك الغذائي اليومي، وتمارينك الرياضية، وأدويتك، وحقن الأنسولين، أو أي أحداث أخرى بالتفصيل.

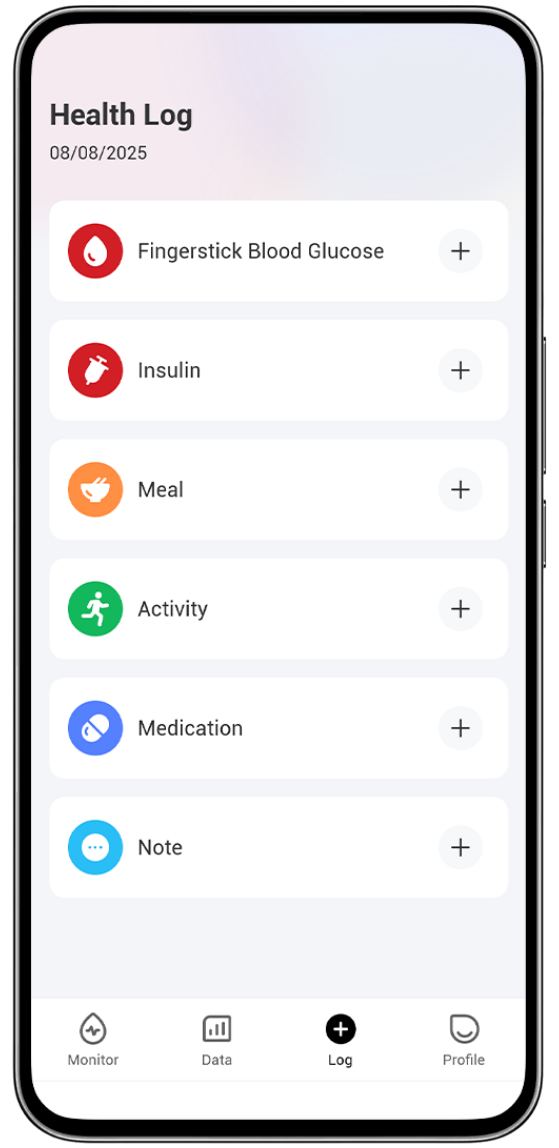

فهم تقرير AGP

- يمكنك الاطلاع على بيانات الجلوكوز على مدار عدة أيام في تقرير AGP بتنسيق 24 ساعة.

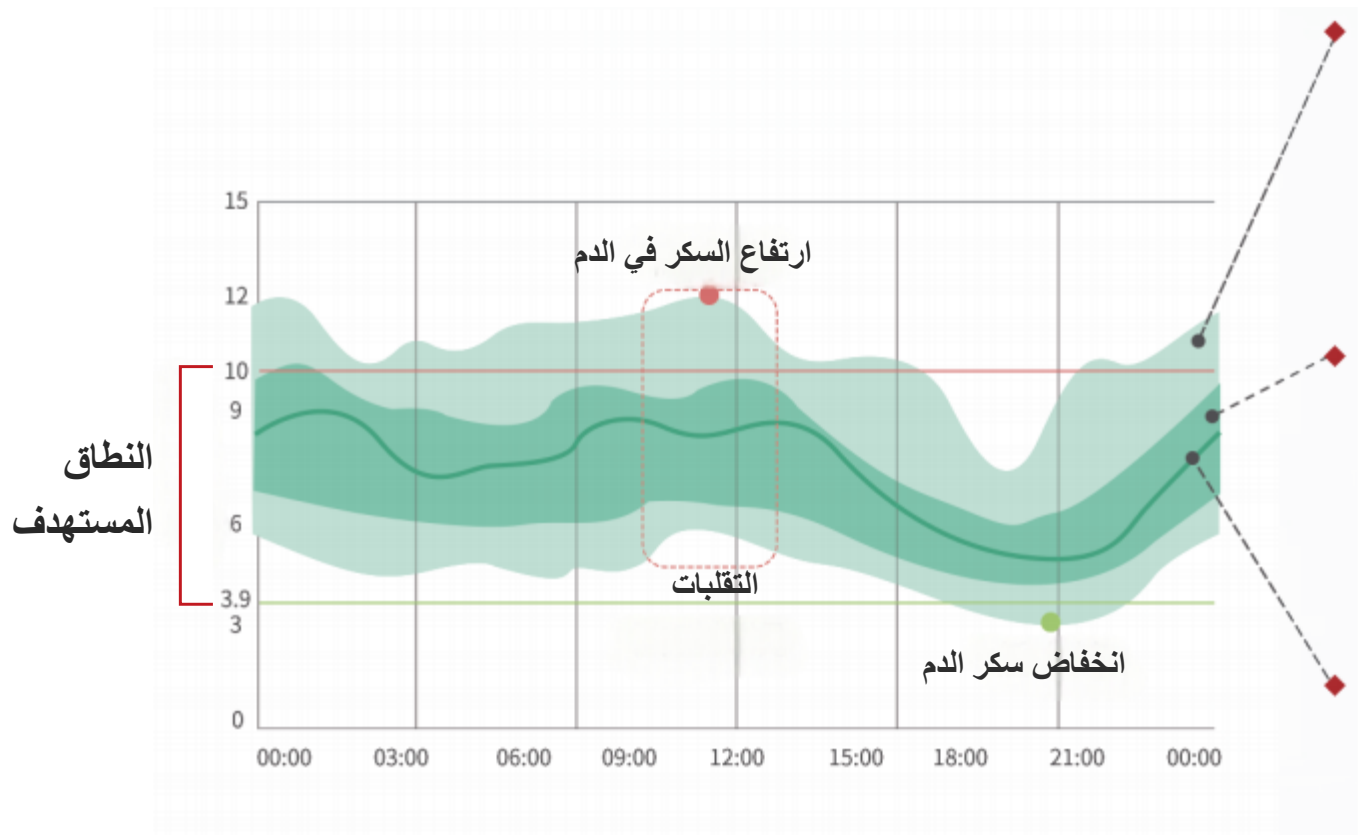

تشير إلى تأثيرات نمط الحياة (النظام الغذائي، التمارين الرياضية، إلخ).

تشير إلى تأثيرات خطة العلاج (تناول الأدوية أو حقن الأنسولين).

تعكس تقلبات مستوى الجلوكوز في الدم اليومية؛ يشير المنحنى الأكثر استواءً إلى استقرار مستويات الجلوكوز في الدم على مدار اليوم.

قارئ بيانات الجلوكوز iCan view

قم بمتابعة بيانات الجلوكوز دون الحاجة إلى جهاز الهاتف

- استخدم قارئ بيانات الجلوكوز iCan view لعرض بيانات الجلوكوز من جهاز **iCan CGM** المرسلة من جهاز الإرسال.

الاستغناء عن الهواتف الذكية
تنبيهات واتجاهات الجلوكوز في الوقت الفعلي على قارئك المستقل عبر اتصال بلوتوث.

تكامل الرعاية عن بُعد
مع شبكة iCan view المدعومة بتقنية الواي فاي، تبقى العائلات والأطباء على اتصال دائم لتقديم رعاية أكثر فعالية.

مصمم ليدوم طويلاً
مقاوم للماء بمعيار IP54، وعمر افتراضي يصل إلى 3 سنوات.

طاقة في حجم الجيب
يناسب الجيب، ويدوم طوال الأسبوع.

تصميم مناسب لجميع الأعمار
من الأطفال الصغار فوق عمر السنتين إلى الأجداد.

من الأطفال الصغار فوق عمر السنتين إلى الأجداد. تقييم وتحسين مستويات الجلوكوز الديناميكية

تحسين مستوى الجلوكوز الديناميكي

الحد من التقلبات
اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق استقرار مستويات الجلوكوز

تجنب انخفاضات الجلوكوز
تتبع أنماط الجلوكوز لتحديد المخاطر، ثم تعديل العلاج بالتشاور مع الطبيب

تمديد الوقت ضمن النطاق المستهدف
استخدام التنبيهات الفورية لاكتشاف القيم المتطرفة مبكرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة للبقاء ضمن النطاق المستهدف

تقييم مستوى الجلوكوز الديناميكي

مراقبة الوقت ضمن النطاق المستهدف
كلما زاد الوقت ضمن النطاق المستهدف، كان ذلك أفضل

تقييم تقلبات الجلوكوز
يُفضل منحنى متوسط أكثر استواءً مع منطقة مظللة أضيق

تقييم خطر نقص سكر الدم
كلما قل الوقت دون النطاق المستهدف، كان ذلك أفضل